

iHealth Clear

Quick Start Guide




Measurement

Fully charge the blood pressure monitor before first use.

1 Rest your bare (or thinly clothed) left arm flat on a table.




2 Place cuff over left arm so the cuff tubing is centered on the inside of your arm and aligned with your middle finger.

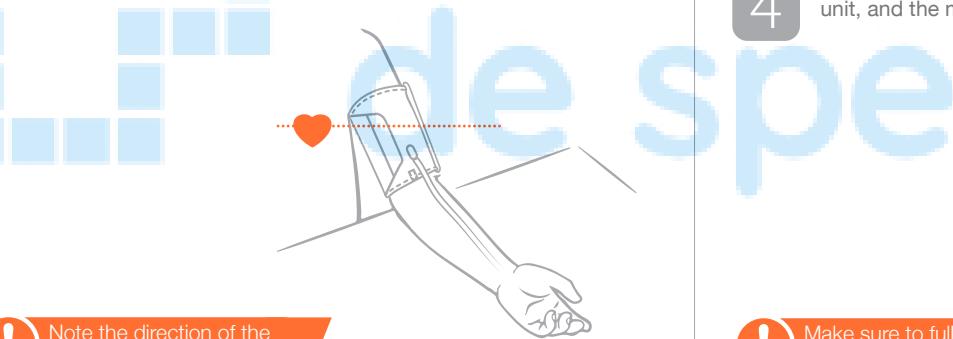


! Note the direction of the cuff tubing and alignment with your middle finger.

3 The bottom of the cuff should be about 1/2" above your elbow. Tighten the cuff firmly, leaving about 1 finger space.

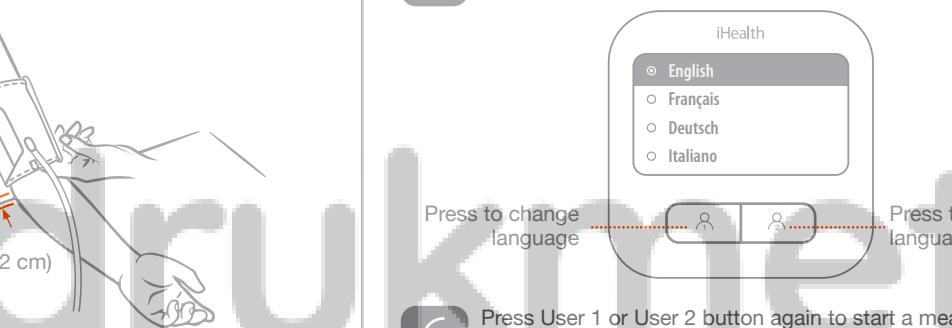

4 Insert cuff tubing connector into blood pressure monitor unit, and the monitor will power on automatically.

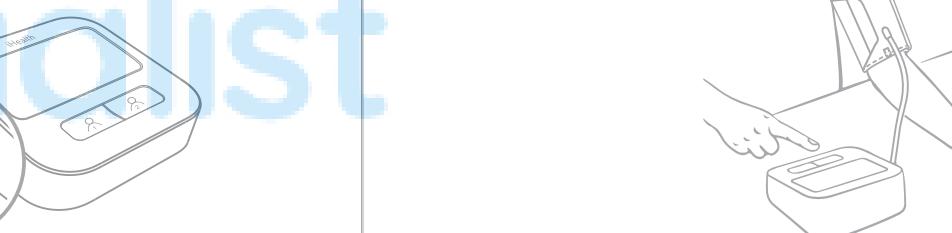

! Make sure to fully insert the cuff tubing connector into the blood pressure monitor.


Wireless Network Setup

1 Go to the Apple App Store or Google Play Store and search "iHealth MyVitals." Download the app and then log in.



iHealth
MyVitals

2 Press and hold the User 2 button for 10 seconds until the screen displays the select language page.

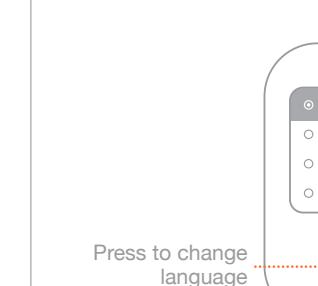


! Press to change language

3 You will need to select your language after turning on the monitor for the first time.


Press to confirm language

6 Press User 1 or User 2 button again to start a measurement. Press any button to stop a measurement and to turn off the monitor.

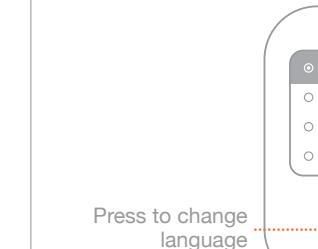

! During the measurement, you will feel the cuff tightening around your arm. Remain still and do not move your arm until the measurement is complete.


3 The screen will display the wireless network setup page. Launch the iHealth MyVitals app, go to Select New Devices and choose Clear (BPM1). Follow the on-screen instructions to finish setting up your wireless network.

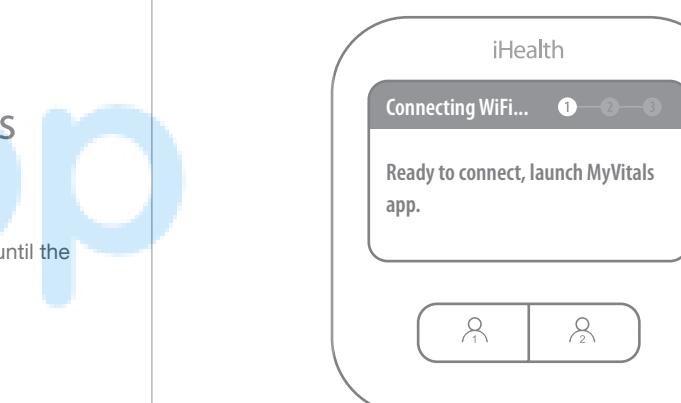

Setup complete! Your blood pressure measurements will automatically upload to the iHealth MyVitals app.

iHealth Clear


Guide de démarrage rapide

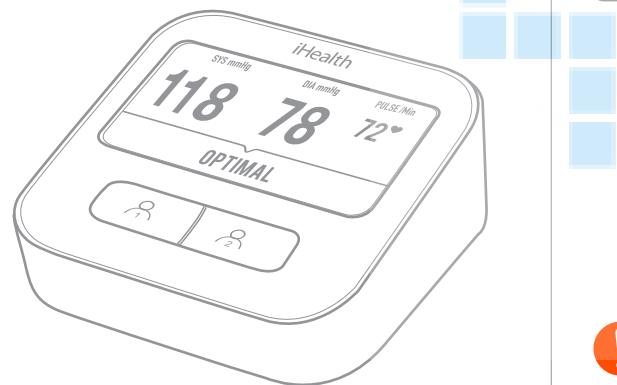

Mesure

Chargez complètement le tensiomètre avant la première utilisation.

- Faites reposer votre bras gauche nu (ou légèrement vêtu) à plat sur une table.

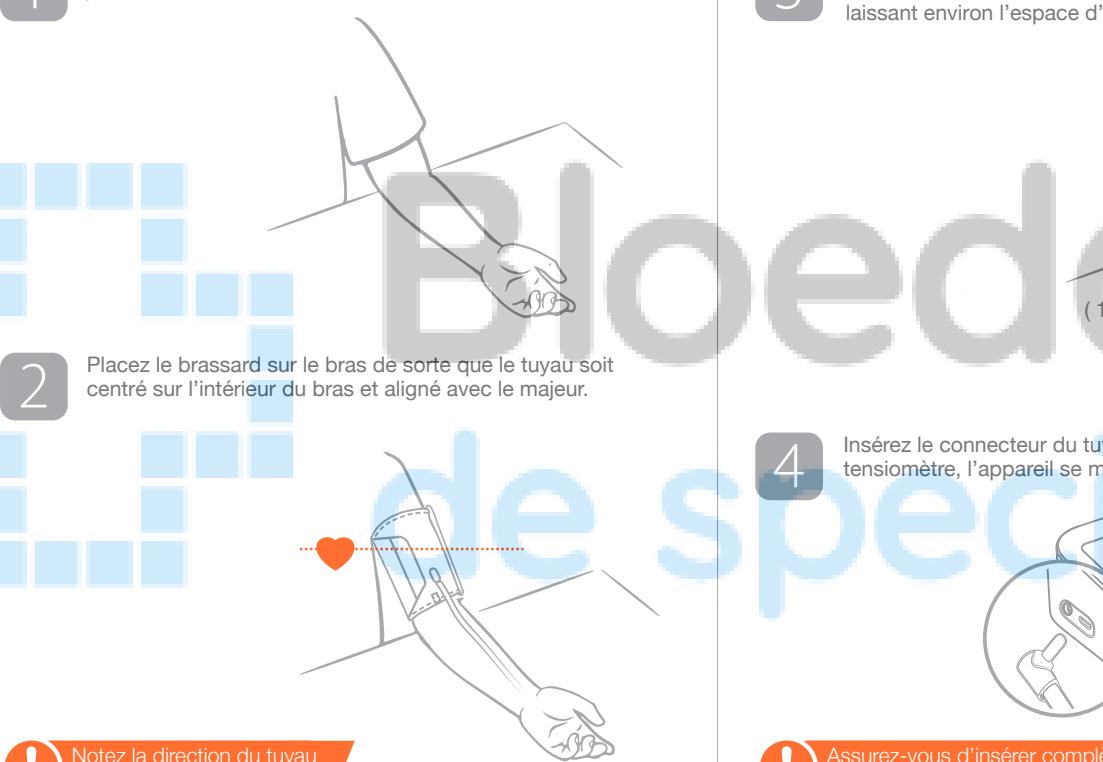

- Placez le brassard sur le bras de sorte que le tuyau soit centré sur l'intérieur du bras et aligné avec le majeur.

! Notez la direction du tuyau du brassard et l'alignement avec votre majeur.

- La partie inférieure du brassard doit être à environ 1 à 2 cm au-dessus du coude. Serrez le brassard fermement, en laissant environ l'espace d'un doigt.



- Insérez le connecteur du tuyau du brassard dans le tensiomètre, l'appareil se met automatiquement sous tension.



! Assurez-vous d'insérer complètement le connecteur du tuyau du brassard dans le port du tensiomètre.


Paramétrage du WLAN

- Allez sur l'App Store d'Apple ou sur Play Store d'Android pour rechercher et télécharger l'application « iHealth MyVitals », puis connectez-vous.



- Appuyez sur pour changer la langue Appuyez sur pour confirmer la langue

6 Appuyez sur la touche Utilisateur 1 ou Utilisateur 2 pour lancer une mesure. Appuyez sur un bouton pour arrêter une mesure et éteindre l'appareil.



- Appuyez sur pour changer la langue Appuyez sur pour confirmer la langue



! Pendant la mesure, vous sentirez le brassard se serrer autour de votre bras. Restez immobile et ne bougez pas le bras jusqu'à ce que la mesure soit terminée.

- Allez sur l'App Store d'Apple ou sur Play Store d'Android pour rechercher et télécharger l'application « iHealth MyVitals », puis connectez-vous.



- Appuyez sur pour changer la langue Appuyez sur pour confirmer la langue

2 Appuyez sur le bouton Utilisateur 2 pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche la page de sélection de la langue.



- Appuyez sur pour changer la langue Appuyez sur pour confirmer la langue



! Pendant la mesure, vous sentirez le brassard se serrer autour de votre bras. Restez immobile et ne bougez pas le bras jusqu'à ce que la mesure soit terminée.

- L'écran affiche la page des paramètres sans fil. Lancez l'application iHealth MyVitals, allez à Sélectionner nouveaux appareils et choisissez Clear (BPM1). Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration sans fil.



Configuration terminée !
Vos mesures de pression artérielle seront automatiquement téléchargées sur l'application iHealth MyVitals.

iHealth Clear

Guida rapida




Misurazione

Caricare completamente lo sfigmomanometro prima del primo utilizzo.


1

Poggiare il braccio sinistro nudo (o con maniche corte) in piano su un tavolo.

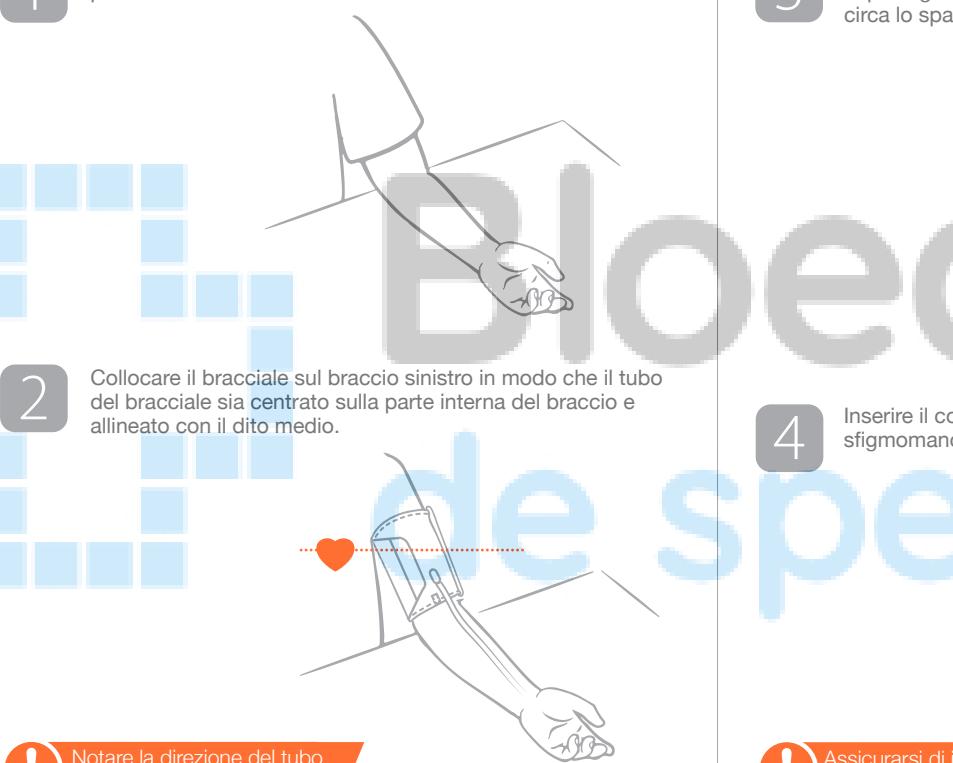

2

Collocare il bracciale sul braccio sinistro in modo che il tubo del bracciale sia centrato sulla parte interna del braccio e allineato con il dito medio.

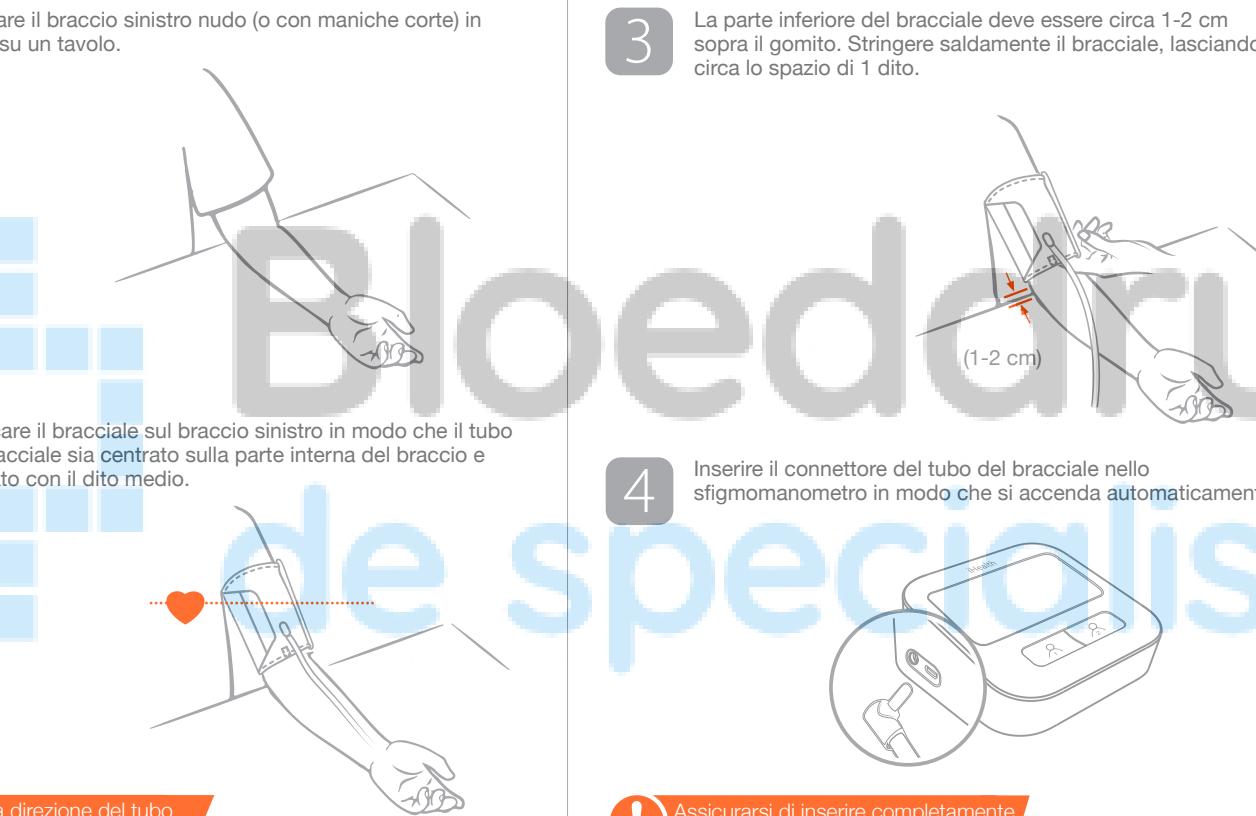

3

La parte inferiore del bracciale deve essere circa 1-2 cm sopra il gomito. Stringere saldamente il bracciale, lasciando circa lo spazio di 1 dito.



4

Inserire il connettore del tubo del bracciale nello sfigmomanometro in modo che si accenda automaticamente.



!

Notare la direzione del tubo del bracciale e l'allineamento con il dito medio.



!

Assicurarsi di inserire completamente il connettore del tubo del bracciale nello sfigmomanometro.



Configurazione WLAN

1 Andare all'Apple App Store o ad Android Google Store per cercare e scaricare l'app "iHealth MyVitals", quindi accedere.



2 Tenere premuto il tasto Utente 2 per 10 secondi finché non viene visualizzata la pagina di selezione della lingua.




3 Sullo schermo viene visualizzata la pagina delle impostazioni senza fili. Avviare l'app iHealth MyVitals, andare a Selezione nuovi dispositivi e selezionare Clear (BPM1). Seguire le istruzioni su schermo per completare la configurazione senza fili.



Configurazione completata! Le misurazioni della pressione sanguigna vengono caricate automaticamente sull'app iHealth MyVitals.

iHealth Clear

Guía de inicio rápido

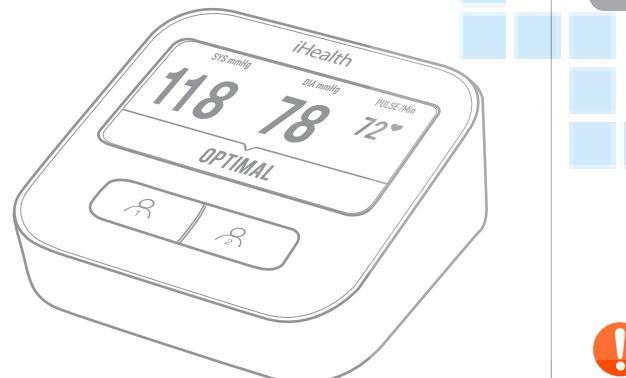

Medición

Cargue completamente el tensiómetro antes de usarlo por primera vez.


1

Extienda el brazo izquierdo desnudo (o con poca ropa) sobre una mesa.



3

La parte inferior del brazalete debe estar 1-2 cm por encima del codo. Apriete el brazalete con firmeza, dejando espacio para 1 dedo aproximadamente.

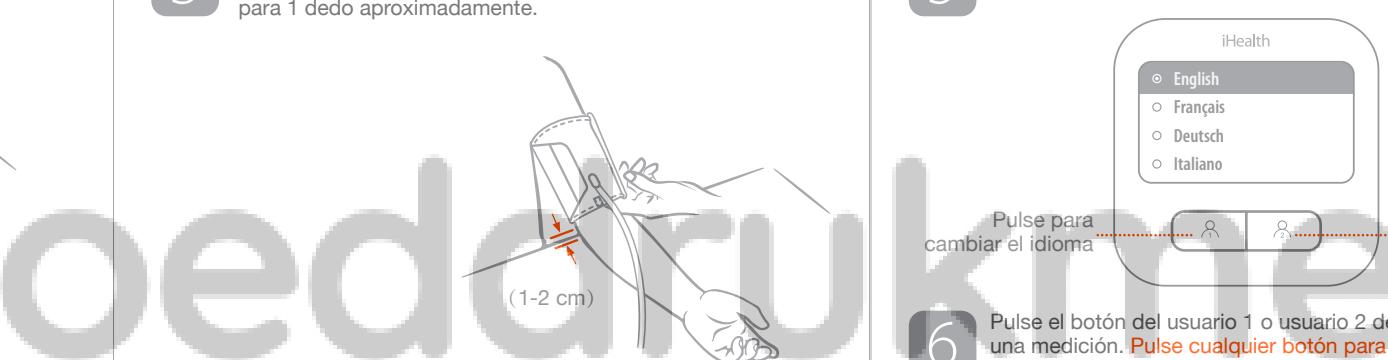

4

Introduzca el conector del tubo del brazalete en la unidad del tensiómetro y este se encenderá automáticamente.



!


Asegúrese de introducir completamente el conector del tubo del brazalete en el tensiómetro.

Configuración WLAN

1 Vaya a la App Store para Apple o la Google Store para Android, busque la aplicación "iHealth MyVitals" y descárguela; luego inicie sesión.



2 Mantenga pulsado el botón del usuario 1 o usuario 2 de nuevo para iniciar una medición. Pulse cualquier botón para parar una medición y apagar el tensiómetro.

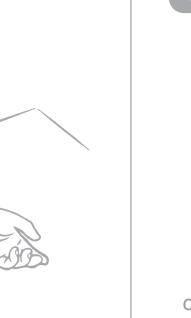

!

Durante la medición, sentirá el brazalete apretando alrededor de su brazo. Quédese quieto y no mueva el brazo hasta que la medición se haya completado.

3 La pantalla mostrará la página de configuración inalámbrico. Inicie la aplicación iHealth MyVitals, vaya a Seleccionar nuevos dispositivos y elija Clear (BPM1). Siga las instrucciones que se muestran en pantalla para finalizar la configuración inalámbrica.




Pulse para cambiar el idioma
Pulse para confirmar el idioma

¡Configuración completada! Sus mediciones de tensión se cargarán automáticamente en la aplicación iHealth MyVitals.



iHealth Clear

Kurzanleitung

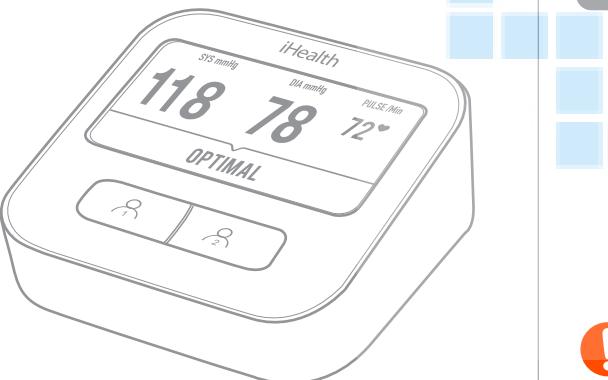

Lade

messgerät vor
vollständig auf.

- Die Unterseite der Manschette sollte Ihres Ellbogens befinden. Ziehen S



An illustration of a person's hand, palm facing up, with fingers slightly spread. A yellow rubber band is wrapped around the middle finger, forming a loop that extends towards the thumb. The index finger is pointing upwards, indicating the direction of the loop.

- Nach dem ersten Einschalten des Messgeräts
Ihre Sprache auswählen.



! Sie werden während der Messung spüren, wie sich die Manschette um Ihren Arm herum zusammenzieht. Bleiben Sie ruhig und bewegen Sie Ihren Arm nicht, bis die Messung abgeschlossen ist.

Einrich

- 1 Suchen Sie im App Store nach der App und melden Sie sich an.



Halten Sie dann die Taste, bis der E anzeigt.




Halten Sie dann die Tasten gedrückt, bis der Balken angezeigt.

- oder im Android Google "Fitlas", laden Sie sie herunter

3 Auf dem Bildschirm wird die WiFi-Einstellungsseite angezeigt. Starten Sie die iHealth MyVitals App, gehen Sie zu Neue Geräte auswählen und wählen Sie Clear (BPM1). Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die WiFi-Einrichtung abzuschließen.




Seite 2 für die Sp

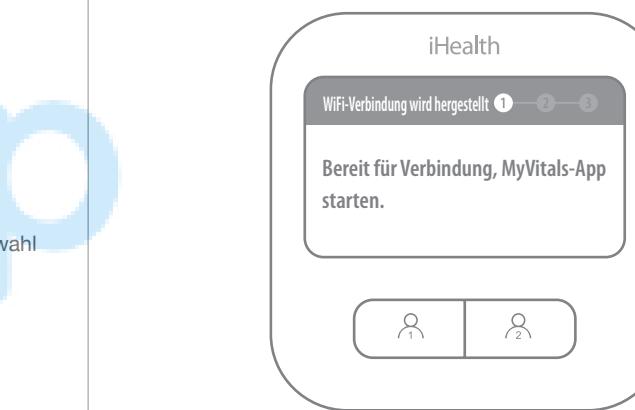

Die Einrichtung ist abgeschlossen! Ihre Blutdruckmessungen werden automatisch auf die iHealth MyVitals App hochgeladen.

iHealth Clear


Guia de iniciação rápida

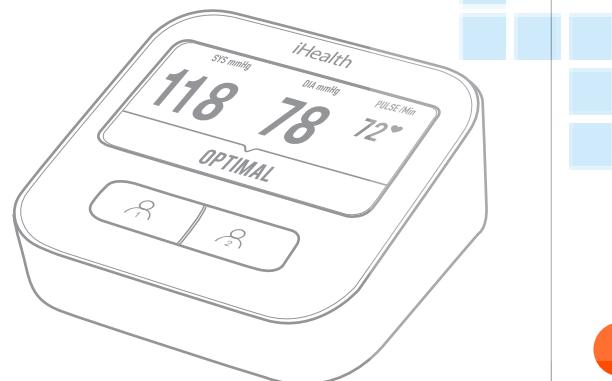


Medição

Carregue totalmente o monitor de tensão arterial antes da primeira utilização.

1 Coloque o braço despido (ou com uma manga fina) sobre uma mesa.

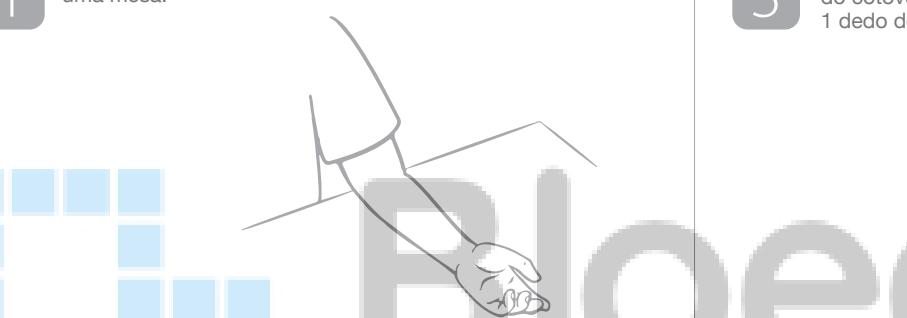


2 Coloque a manga sobre o braço esquerdo para que a tubagem da manga esteja centrada no parte de dentro do braço e alinhado com o dedo médio.

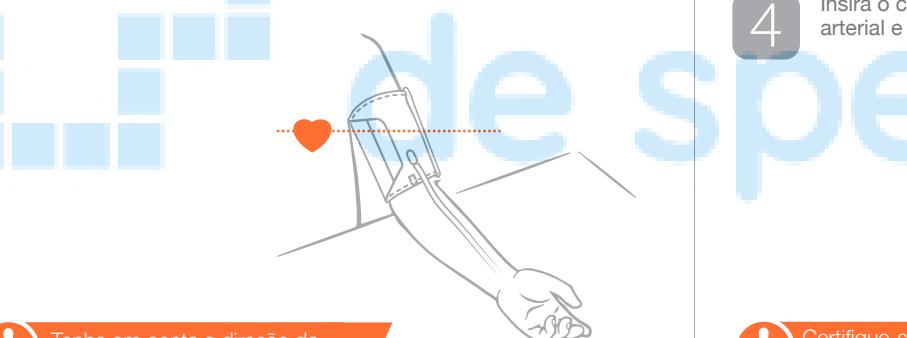

! Tenha em conta a direção da tubagem da manga e o alinhamento com o dedo médio.

3 A parte de baixo da manga deve estar cerca de 1-2 cm acima do cotovelo. Aperte firmemente a manga, deixando cerca de 1 dedo de espaço.

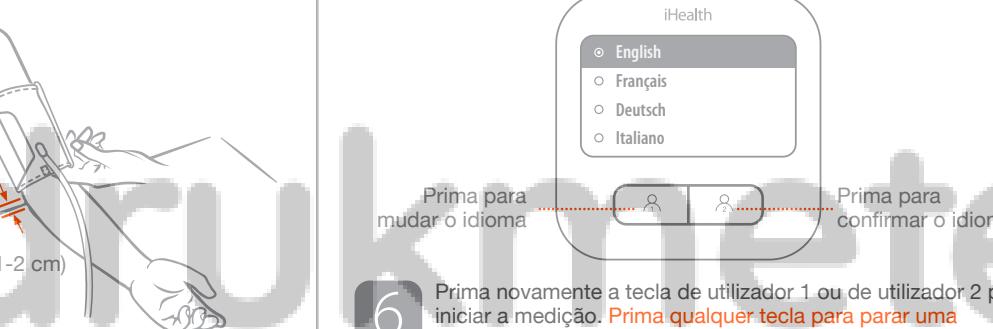

4 Insira o conector da tubagem da manga no monitor de tensão arterial e o monitor liga-se automaticamente.



! Certifique-se de que insere totalmente o conector da tubagem da manga no monitor de tensão arterial.

Configuração da ligação WLAN

1 Aceda à Apple App Store ou à Android Google Store, pesquise a aplicação "iHealth MyVitals", transfira-a e inicie sessão.



2 Mantenha premida a tecla de utilizador 2 durante 10 segundos até que o ecrã apresente a página de seleção do idioma.



! Prima para mudar o idioma
Prima para confirmar o idioma.

3 O ecrã apresenta a página de definições sem fio. Inicie a aplicação iHealth MyVitals, aceda a Selecionar dispositivos e escolha Clear (BPM1). Respeite as instruções no ecrã para concluir a configuração da ligação sem fio.




4 Pronta a ligar, iniciar a aplicação MyVitals.



Configuração concluída! As medições da tensão arterial serão automaticamente carregadas na aplicação iHealth MyVitals.

iHealth Clear

Snelstartgids

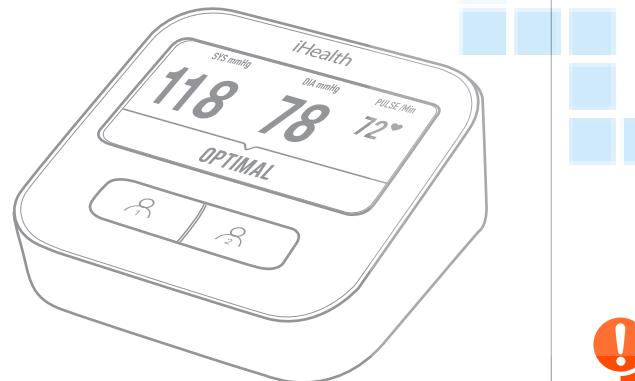

Meting

Laad de bloeddrukmeter volledig op voor het eerste gebruik.

- Leg uw blote (of dun geklede) linkerarm plat op een tafel.

- Plaats de manchet over de linkerarm zodat de manchetbuis is gecentreerd op de binnenkant van uw arm en in een lijn ligt met uw middelvinger.



! Controleer de richting van de manchetbuis en de ligging m.b.t. uw middelvinger

- De onderkant van de manchet zou ongeveer 1-2 cm boven uw elleboog moeten liggen. Maak de manchet stevig vast en houd ruimte over voor ongeveer 1 vinger.



- Voeg de manchetverbindingsbuis in de bloeddrukmeter en de meter zal zich automatisch inschakelen.



! Zorg ervoor dat u de manchetverbindingsbuis volledig in de bloeddrukmeter stekt.

WLAN instellen

- Ga naar de Apple App Store of Google Play Store en zoek naar de app "iHealth MyVitals" en download deze, log vervolgens in.



- Druk nogmaals op de Gebruiker 1- of Gebruiker 2-knop en houd deze 10 seconden ingedrukt tot het scherm de taalselectiepagina weergeeft.



! Tijdens de meting voert u de manchet strakker worden om uw arm. Blijf stil en beweeg uw arm niet tot de meting is voltooid.

- Het scherm zal de WLAN-instellingsspagina weergeven. Open de app iHealth MyVitals, ga naar Nieuwe apparaten Selecteren en kies Clear (BPM1). Volg de instructies op het scherm om het instellen van de WLAN te voltooien.




- Klaar om te verbinden, start de app MyVitals.



Installatie voltooid! Uw bloeddrukmetingen zullen automatisch geüpload worden naar de app iHealth MyVitals.

iHealth Clear

Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης

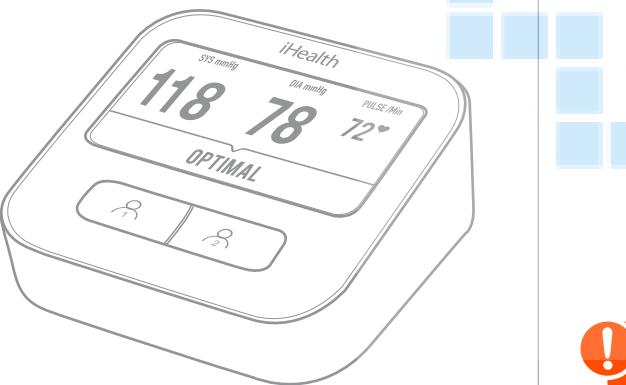

Μέτρηση

Φορτίστε πλήρως το πιεσόμετρο πριν από την πρώτη χρήση του.


- 1 Ακουμπίστε ίσιο το αριστερό σας χέρι, γυμνό (ή με ελαφρύ ρούχο) επάνω στο τραπέζι.



- 2 Αριστερό σας χέρι έτσι ώστε ο σωλήνας του να είναι κεντραρισμένος στην εσωτερική πλευρά του μπράτσου σας και ευθυγραμμισμένος με το μεσαίο σας δάχτυλο.

! Μην ξεχάστε την κατεύθυνση του σωλήνα του περιβραχίονού και την ευθυγράμμισή του με το μεσαίο σας δάχτυλο.

- 3 Το κάτω μέρος του περιβραχίονού πρέπει είναι περίπου 1-2 εκατοστά πάνω από τον αγκώνα σας. Σφίξτε καλά το περιβραχιόνιο αφήνοντας περίπου 1 δάχτυλο κενό.

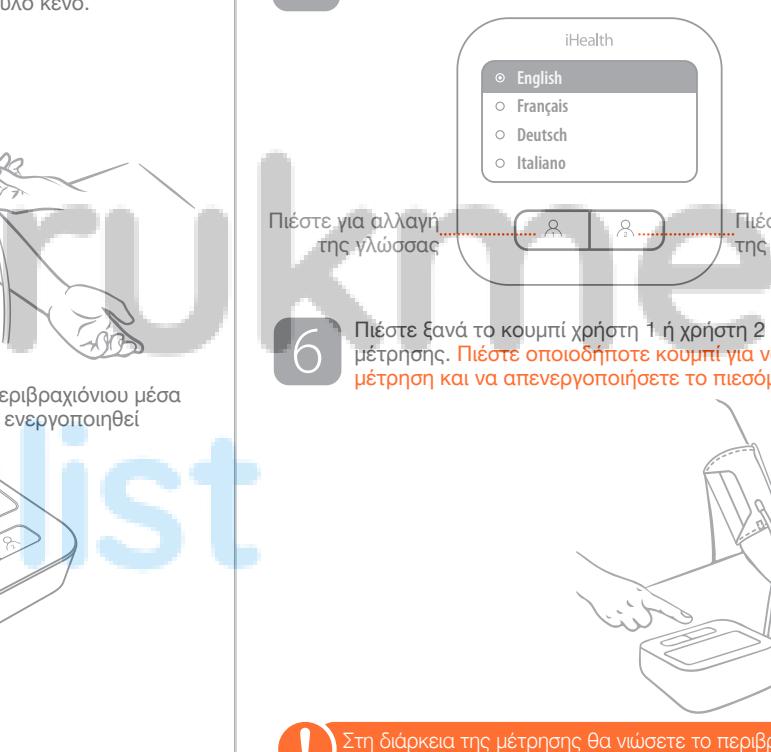

- 4 Περάστε τον σύνδεσμο του σωλήνα του περιβραχίονού μέσα στη μονάδα του πιεσόμετρου το οποίο θα ενεργοποιηθεί αυτόμata.

! Φροντίστε να περάσετε τον σύνδεσμο του σωλήνα του περιβραχίονού τέρμα μέσα στο πιεσόμετρο.

Ρύθμιση WLAN

- 1 Πηγαίνετε στο Apple App Store ή στο Google Play Store για την εφαρμογή «iHealth MyVitals», προχωρήστε στη λήψη της και ύστερα συνδεθείτε.




- 2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί χρήστη 2 επί 10 δευτερόλεπτα ωστόσου παρουσιαστεί η σελίδα επιλογής γλώσσας στην οθόνη.



Πιέστε για αλλαγή της γλώσσας

! Στη διάρκεια της μέτρησης θα νώσετε το περιβραχίονο να αφίγγει γύρω από το μπράτσο σας. Μείνετε ακίνητοι και μη μετακινήστε το μπράτσο σας ωστόσου ολοκληρωθεί η μέτρηση.

- 3 Στην οθόνη θα παρουσιαστεί η σελίδα με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας WLAN. Εκκινήστε την εφαρμογή iHealth MyVitals, πηγαίνετε στη δυνατότητα «Επιλογή νέων συσκευών» και επιλέξτε το Clear (BPM1). Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση της λειτουργίας WLAN.

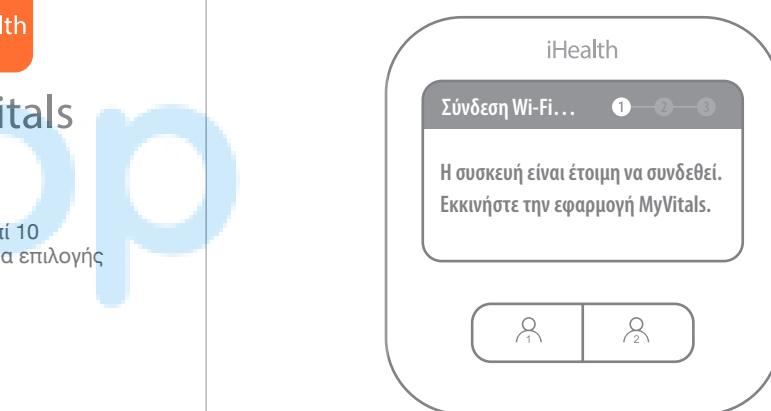

του αίματός σας θα αναφορτώνονται αυτόμata στην εφαρμογή iHealth MyVitals.